基準接地板 GP01-KES
取扱説明書

本器は静電気放電シミュレータ KES4020 専用のオプションです。

静電気放電シミュレータ KES4020 の取扱説明書、付録の「1.2 試験環境と試験配置」を先にお読みください。一般事項および共通事項は静電気放電シミュレータ KES4020 の取扱説明書にしたがってください。

1. 概要

本器は、IEC61000-4-2 規格に準拠した静電気放電試験用環境設備です。

2. 仕様

材質：表面アルミ　t=1.6 ㎜
　　裏面厚板　　t=12 ㎜
寸法：1800 × 900 × 13.6 ㎜（1 枚時）
　　3 枚 1 組（3 枚接続時面積：1800 × 2700 ㎜）
接続板：400 × 50 × 5 ㎜

3. 本体および付属品

本体

・基準接地板　3

付属品

・接続板　6
・接続板取り付け用 M4 ねじ　48

4. 使用方法

試験を行う部屋の床に敷き、接地をして使用します。

接地は、基準接地板接続用の穴などを利用して電気設備基準 - 第 3 種以上の接地工事が施されている大地アースへ接続してください。

5. 組み立て

1.- 表面を上にして置き、長辺の縁に接続板を3枚づつM4皿ねじで止めます。
2.- 接続板を使い各側面に基準接地板をそれぞれM4皿ねじで接続します。

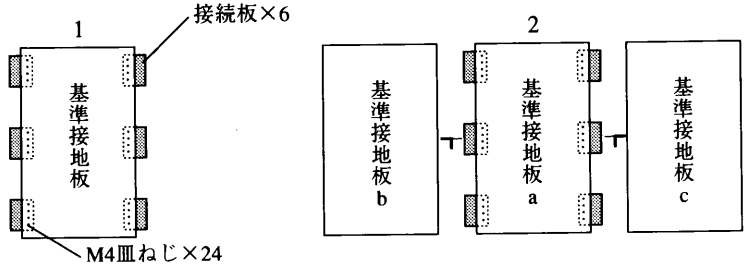

注　意

- 本器は組立式になっています。移動は、3枚に分解してから行ってください。
- 基準接地板の縁と床面との段差に注意してください。

菊水電子工業株式会社
〒224-0023　横浜市都筑区東山田 1-1-3　　TEL045-593-0200　　FAX045-593-7591
© 1998 Kikusui Electronics Corporation　Printed in Japan
Kikusui Part No. Z1-001-990, IA001182